

460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д.41  
Телефон: +7(3532) 37 00 00  
Email: office\_oren@rosvodokanal.ru  
<http://www.oren-vodokanal.ru/>



№ 02/1824 от 18.04.2016  
На № КС-018/16 от 05.04.2016г.

Директору  
ЗАО «Термотроник»

С.И. Резлеру

Уважаемый Сергей Игоревич!

В ответ на Ваше письмо ООО «Оренбург Водоканал» сообщает, что для проведения тестирования электромагнитного расходомера «Питерфлоу РС» 50-36, класса «В», Ду50, с функцией архивирования, серийным номером №050846 производства ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» (г. Санкт-Петербург) была проведена установка данного прибора учета воды последовательно на одном трубопроводе ХВС с расходомером РМ-5.

За время эксплуатации нареканий на работу оборудования не возникло. Блок индикации позволил контролировать показания прибора, калибровочные коэффициенты, номер прибора, вес импульса, режим работы выходных сигналов. Электроника расположена в герметичном опломбированном отсеке. Образования конденсата в магнитной системе за весь период не зафиксированы, датчик пустой трубы и загрязнения электродов в системе диагностики работали корректно.

По итогам испытания было произведено снятие архивных данных (Приложение 1). По произведенному анализу отчетов можно сделать вывод, что оборудование работало исправно и корректно фиксировало расходы воды потребителем, незначительное расхождение в показаниях двух расходомеров составляет не более 0,1%, что говорит о хороших метрологических характеристиках.

Приложение: Графики суточных и почасовых показаний приборов учета ХВС на 1л. в 1экз.

Генеральный директор

М.В. Иванов

Прохожев И.А.  
(3532)37 00 00(6341)

График суточных показаний приборов учета ХВС  
с 10.02.2015 по 22.09.2015

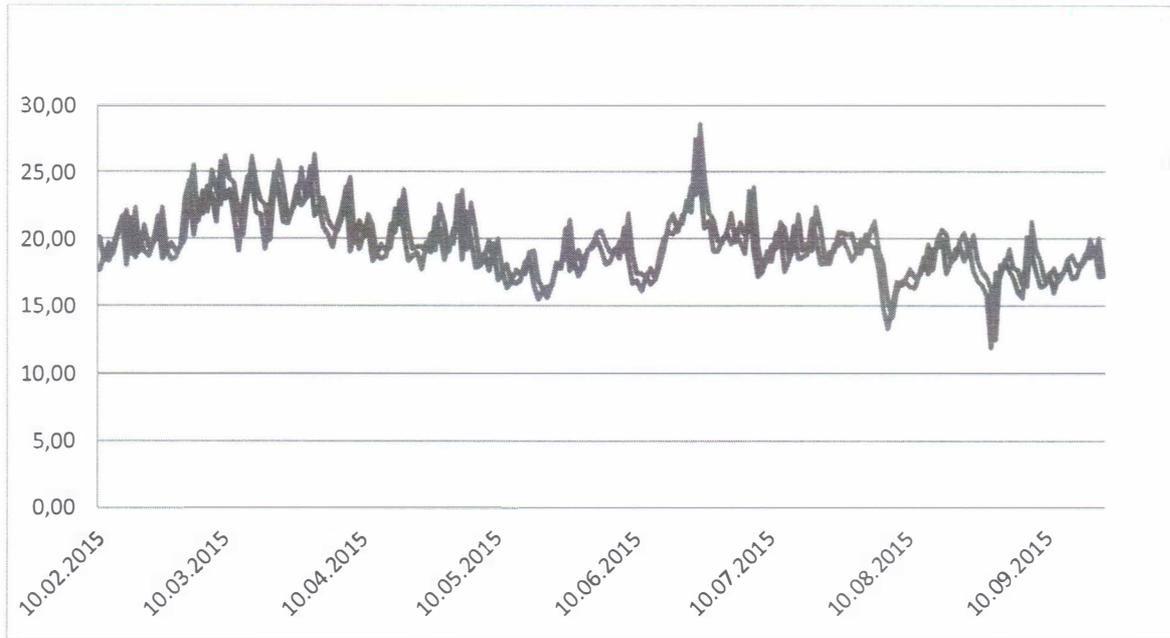


График почасовых показаний приборов учета ХВС  
с 04.08.2015:00:00 по 06.08.2015:00:00

